Avalon CTS Langaton sikiöanturijärjestelmä **M2720A**

Varoitukset ja niiden aiheuttamat toimet

Tukiasemaa koskevat varoitukset: vilkkuu yksin tai jommankumman merkkivalon kanssa. tarkoittaa, että merkkivalo ei pala tai että se palaa jatkuvasti.

tarkoittaa, että laite antaa hälytysäänimerkin, jos se on määritetty käyttöön. Vaienna äänimerkki painamalla C-painiketta.

Antureita koskevat varoitukset: vilkkuu yhdessä ongelman aiheuttajaa kuvaavan symbolin kanssa.

Varoitus		Toimenpide
Tukiasemassa	**Anturissa**	
		Lataa anturin akku kytkemällä anturi tukiasemaan tai vaihda tilalle uusi anturi, jonka akku on täyteen ladattu. Jos ongelma jatkuu 30 minuutin pituisen latausjakson jälkeen, vaihda anturin akku. (Lisätietoja on *huolto-oppaassa*.)
		Tarkista, että anturi on aktiivinen ja antennin kantoalueella. Tarkista anturiliitäntä.
		Avaa suljettu anturipaikka painamalla C-painiketta kahden sekunnin ajan.
Esimerkkipotilaspaikan numero		Tässä paikassa on jo **aktiivinen** anturi (jossa näkyy potilaspaikan numero, tässä esimerkissä 38). Voit *joko* vapauttaa paikan kytkemällä tämän anturin ensin
Esimerkkipotilaspaikan numero	Esimerkkipotilaspaikan numero	*tai* jos anturissa näkyy potilaspaikan numero (tässä esimerkissä 16), palauttaa anturin omaan tukiasemaansa.
		Ota yhteys huoltoon (anturi ei kyennyt rekisteröitymään).
		Jos kyseessä on aktiivinen EKG-anturi, kytke kaapeli. Aseta anturi tukiasemaan pisteellä merkittyyn paikkaan (anturi on väärässä paikassa).
Tukiaseman ja anturin virheviestit (E0–E9): Katso *Käyttöopas*		

© 1995–2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Painettu Saksassa 04/2006
Osanumero M2720-9039B
4512 610 14981

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str. 2
71034 Böblingen, Germany

PHILIPS

Avalon CTS Langaton sikiöanturijärjestelmä **M2720A**
Pikaopas

1 110–240 V AC



2 Kytke virta

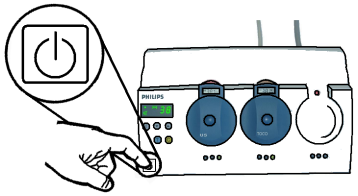

3

TELE

Varmista, että kardiotokografin TELE-merkkivalo palaa. Merkkivalo osoittaa, että yhteys Avalon CTS -järjestelmään on hyvä.

4 Odota, kunnes valmis-valo syttyy.



5 Poista anturi.



Valmis-valo sammuu: RF-linkin merkkivalo syttyy.

6 Kiinnitä anturi (käytä ultraäänitutkimuksessa geeliä).

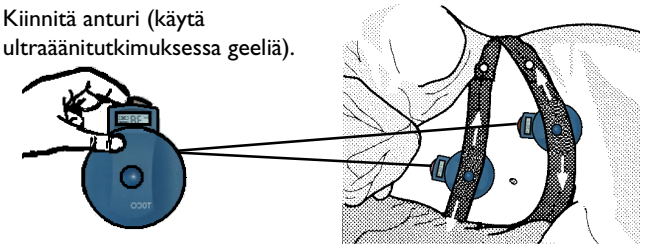

Varmista kiinnitys, kun signaali on hyvä:

Avalon-kardiotokografit

Sarjan 50 kardiotokografit

Siirtyminen UÄ-monitoroinnista suoran EKG:n monitorointiin	
1	Kytke UÄ-anturi tukiasemaan.
2	Poista EKG-anturi, kun anturipaikan merkkivalo on vihreä.
3	Liitä suoran EKG:n sovitinkaapeli ja sikiön skalppielektrodi EKG-anturiin.
4	Aloita suoran EKG:n monitorointi.

Siirtyminen suoran EKG:n monitoroinnista UÄ-monitorointiin	
1	Irrota suoran EKG:n sovitinkaapeli ja sikiön skalppielektrodi EKG-anturista.
2	Kytke EKG-anturi tukiasemaan.
3	Poista UÄ-anturi, kun anturipaikan merkkivalo on vihreä.
4	Aloita ultraäänimonitorointi.

Irrota kaikki langalliset sikiöanturit kardiotokografista ennen Avalon CTS:n käytön aloittamista.

Jos kaksi aktiivista anturia lähettää sikiön sykkeen samaan tukiasemaan, järjestelmä antaa virheviestin **E9**. Voit poistaa viestin kytkemällä toisen anturin tukiasemaan.

Käytön jälkeen: Puhdista anturit. Aseta ne sitten oikeaan anturipaikkaan.